
SILVERFOX

Appareil de beauté


F-312B

Appareil de beauté

◆ F-312B Ultrasons (uniquement pour les soins de beauté)

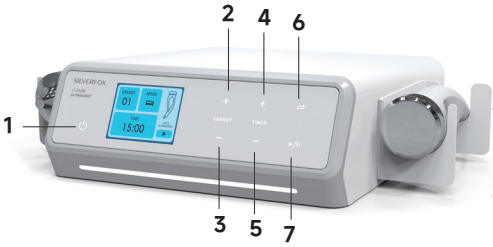

1. Interrupteur d'alimentation
2. Puissance
   Augmenter +
3. Puissance
   Diminuer -
4. Augmenter la durée +
5. Diminuer la durée -
6. Sélection du mode
7. Démarrer/Pause

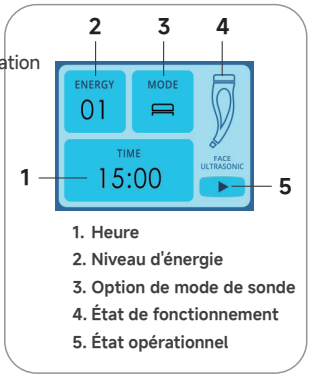

1. Heure
2. Niveau d'énergie
3. Option de mode de sonde
4. État de fonctionnement
5. État opérationnel

Mode de fonctionnement

1. Insérez la sonde à ultrasons dans la prise correspondante de l'appareil. Une fois l'appareil correctement branché au câble d'alimentation, le « bouton d'alimentation » s'allume en rouge. Appuyez sur le « bouton d'alimentation » pour passer en mode de fonctionnement ; l'écran s'affiche alors en blanc. L'appareil démarre par défaut en mode de sortie de sonde oculaire ; par conséquent, la durée de sortie de niveau 1 est réglée sur 15 minutes.

2. Vous pouvez sélectionner différents modes en fonction de vos besoins ; appuyez sur le « commutateur de mode » pour sélectionner le mode de sortie approprié, qui peut être une sortie positive, une sortie négative ou un mode de sortie mixte.

3. Appuyez sur le « bouton d'augmentation/diminution de la durée », qui vous permet de régler la durée de fonctionnement de 1 à 30 minutes.

4. Appuyez sur le bouton « Start » / « Pause » pour démarrer l'opération. Le niveau de puissance est réglable, ce qui permet de le configurer de 1 à 10.

5. Si vous souhaitez que la sonde à ultrasons s'arrête pendant le fonctionnement, vous pouvez appuyer sur le bouton « Pause ».

6. Appuyez sur l'« interrupteur d'alimentation » pour éteindre l'appareil une fois l'opération terminée ; à ce moment-là, l'« interrupteur d'alimentation » s'allumera en rouge. Nettoyez la sonde à ultrasons avec de l'alcool à 75 % après avoir débranché le câble d'alimentation et rangez-la dans un endroit sec.

Durée d'utilisation recommandée

Adaptez la durée en fonction de l'épaisseur de la peau ; en général, la durée du traitement ne dépasse pas 15 minutes.

Avertissement : ne mettez pas la partie métallique de la sonde en contact avec l'eau

Précautions d'emploi F-312B

⚠ Avertissement

- Ne dirigez pas la sonde directement vers le globe oculaire, ne touchez pas l'œil et ne massez pas la paupière supérieure.
- Ce traitement est contre-indiqué pour les groupes suivants :
  1. Les femmes enceintes et les personnes portant un stimulateur cardiaque ;
  2. Les patients atteints de tumeurs ou de maladies cardiaques graves ;
  3. Les brûlures cutanées, les échaudures, les coups de soleil, les inflammations ou autres lésions ;
  4. Les patients allergiques et les personnes souffrant de dermatite de contact.
- Il est interdit d'ouvrir la sonde sans effectuer une intervention esthétique, afin d'éviter tout risque de brûlure dû aux températures élevées et de réduire la durée de vie de la sonde en raison d'une surchauffe.
- Ne retirez pas vous-même la sonde et la poignée en acier inoxydable. Si vous tournez la sonde et la poignée en acier inoxydable, la sonde pourrait être endommagée.
- Cette fonction ne doit pas être utilisée à des fins autres qu'esthétiques.

⚠ Attention

- Avant le traitement, il est nécessaire d'appliquer une quantité suffisante de crème ou d'essence sur la zone à traiter afin d'assurer un bon contact entre la sonde et la peau, et d'éviter ainsi de trop tirer sur celle-ci.
- Pendant l'utilisation, la sonde doit rester en contact avec la peau afin d'éviter la cavitation et les lésions cutanées.
- Pendant l'utilisation, la sonde ne doit pas rester en mode émission sans être en fonctionnement, car cela pourrait l'endommager ou réduire sa durée de vie.
- Si la sonde est trop chaude, elle peut brûler la peau ; par conséquent, la durée d'utilisation ne doit pas dépasser 15 minutes ; dans le cas de peaux sensibles, il convient de réduire la durée d'utilisation et l'intensité de l'énergie. Allonger la durée d'utilisation n'améliore pas l'effet du traitement et peut présenter un danger. Il faut veiller à ce que le temps de contact avec la peau ne dépasse pas 5 secondes.
- Après le traitement, la peau présentera une brève rougeur due à la vibration de la sonde et à la génération de chaleur, ce qui augmente la circulation sanguine ; il s'agit d'un phénomène normal.

Parámetros del producto

Référence du produit	F-312B
Tension/Fréquence	AC 100V-240V,50/60Hz
Puissance	11W
Dimensions du produit	20.8×23×7.5 cm
Dimensions de l'emballage	37×27.5×14 cm
Contenu de l'emballage	Unité principale × 1
	Étagère pour accessoires × 2
	Sonde ultrasonique plate avec embout en acier inoxydable × 1
	Sonde ultrasonique plate en acier inoxydable × 1
	Câble d'alimentation × 1



Ne jetez pas vos appareils électroménagers usagés ou défectueux avec les ordures ménagères ; ils doivent être déposés uniquement dans les points de collecte publics.

▲ Veuillez consulter les caractéristiques techniques du produit avant de l'utiliser. Ce manuel est fourni à titre informatif uniquement. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.